Installation de la table à hauteur réglable

[reportez-vous au guide de l'utilisateur pour une description des symboles de sécurité]

S'applique aux modèles :

222 (tous)
223 (tous)
622 (tous)
623 (tous)

Avertissement matériel

Il est impératif de respecter ces instructions pour éviter tout endommagement de la table.

NE JAMAIS pousser les plaques de la base.

NE JAMAIS utiliser les étriers pour soulever la table.

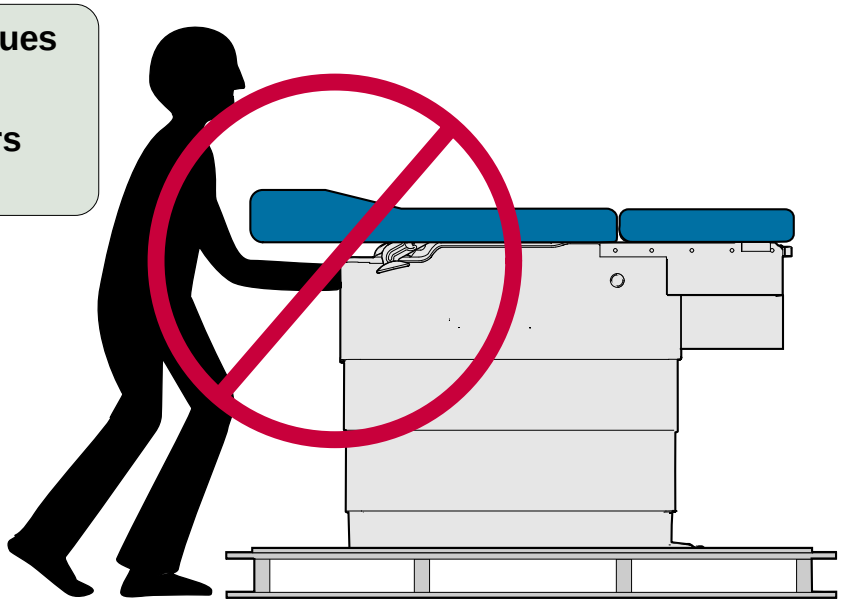

TOUJOURS transporter la table en position " à plat ".

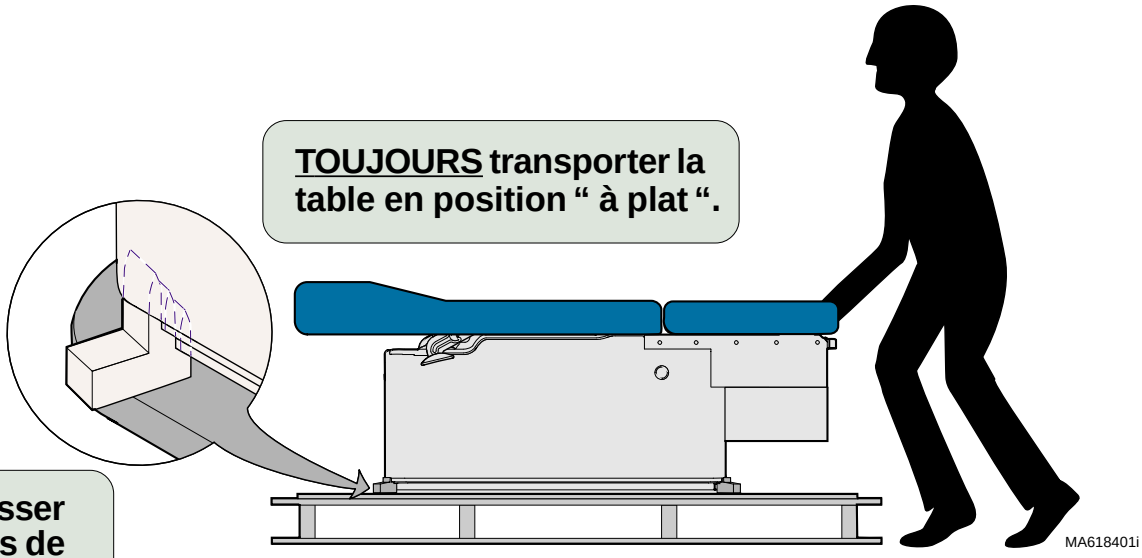

TOUJOURS laisser (4) les supports de la plaque de la base en place jusqu'à la livraison finale.

© Midmark Corporation 2003

003-1359-00 Rév. (A)

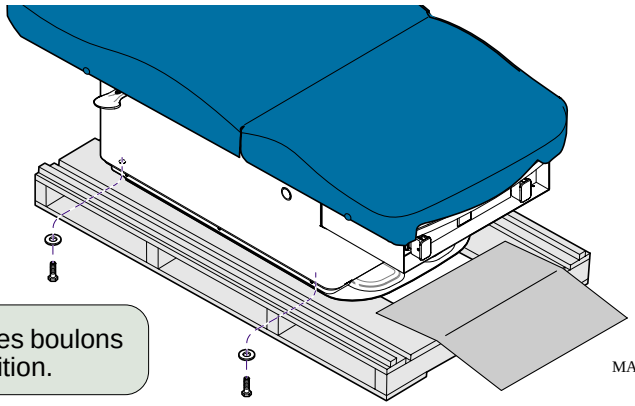

Étape 1 : Retirez les boulons d'expédition.

MA622700i

Avertissement matériel

La table doit être mise à niveau afin d'assurer un fonctionnement correct.



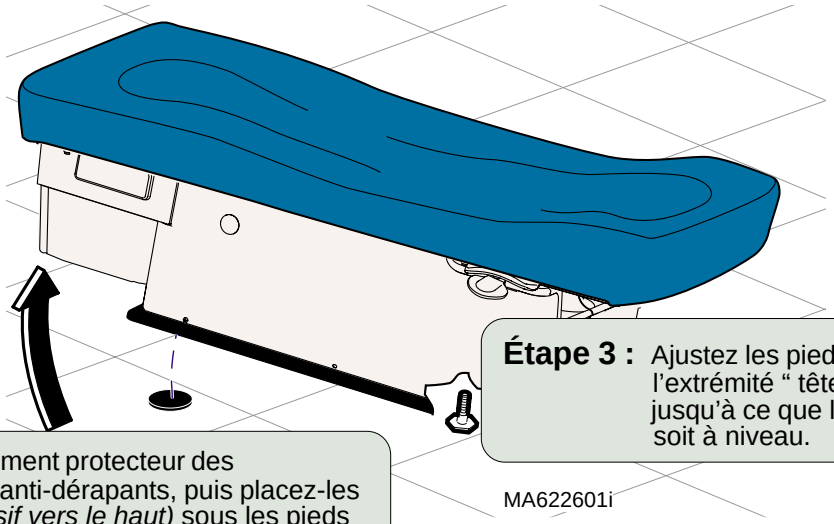

Étape 3 : Ajustez les pieds à l'extrémité " tête " jusqu'à ce que la table soit à niveau.

Étape 2 : Retirez l'élément protecteur des coussinets anti-dérapants, puis placez-les *(côté adhésif vers le haut)* sous les pieds à l'extrémité " pieds " de la table.

MA622601i

Alimentation électrique

Modèles : 222, 223 et 622 (115 V c.a.)
Alimentation sur circuit réservé : 115 V c.a., 50/60 Hz, 15 A

Modèle : 623 (115 V c.a.)
Alimentation sur circuit réservé : 115 V c.a., 50/60 Hz, 20 A

Modèles : série 222 ou 223 (230 V c.a.)
Alimentation sur circuit réservé : 230 V c.a., 50/60 Hz, 15 A

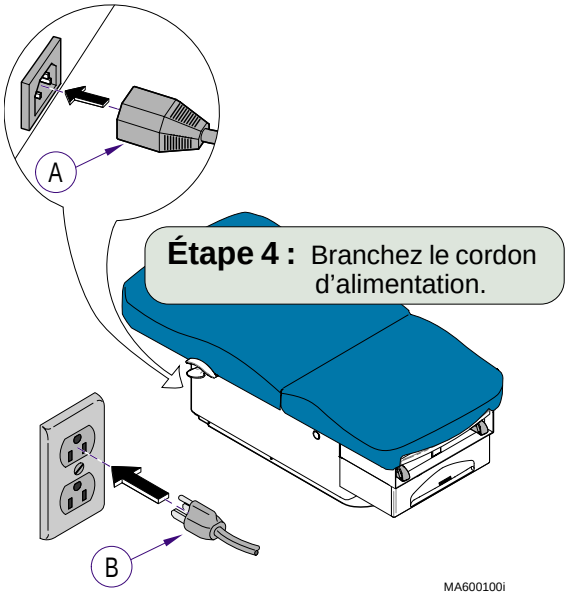

Étape 4 : Branchez le cordon d'alimentation.

MA600100i

Remarque

Cette étape s'applique aux modèles 223 et 623 uniquement.

Étape 5 : Branchez la pédale de contrôle.
223 : *extrémité " pieds "*
623 : *extrémité " pieds " ou " tête "*

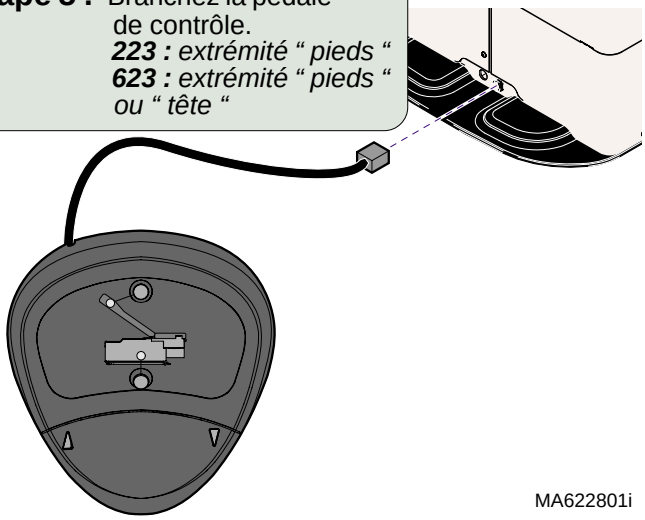

MA622801i

© Midmark Corporation 2003